

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 email:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. crt. 15230/19.07.2021

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
TERMOSTAT LABORATOR**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5, jud. Iasi , CUI 4701371 , intentioneaza sa achizitioneze “ **1 buc -TERMOSTAT LABORATOR** ”, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 22.07.2021, ora 12.00 la sediul spitalului .

Oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

Manager
Dr. **Bechir Daniel**



Compartiment achizitii publice
Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud. Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 15130/16.07.2021



Dr. Bechir Daniel



CAIET DE SARCINI TERMOSTAT LABORATOR -1 BUC

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str. Gradinitei nr.5, loc. Pascani, jud. Iasi este interesat in achizitionarea „TERMOSTAT LABORATOR -1 BUC”, cod CPV42943210-3.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „TERMOSTAT LABORATOR -1 BUC ” ,cod CPV42943210-3.
Produsul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :
 - Marcajul European de conformitate CE inscriptionat ;
 - Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

4. SPECIFICATII TEHNICE :

Caracteristici obligatorii:

Camera termostat trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici :

- sa asigure temperatura de 37 grade C
- dimensiuni exterioare : 2000x 900x2000 (lungime ,adancime ,inaltime)
- volum util : 2000 litri
- incinta din inox
- constructie monobloc
- rafturi perforate prevazut cu sistem recirculator
- afisaj electronic de temperatura
- protectie automata la supratemperatura cu declupare automata
- tensiune de alimentare 220 V
- prevazut cu sistem de alarma in cazul disfunctionalitatilor
- insotit de certificat de etalonare emis de catre un laborator de etalonare
- termostatul sa fie prevazut cu sistem de sterilizare cu raze UV
- termostatul sa fie avizat de Ministerul Sanatatii si sa aiba declaratie de conformitate
- sa aiba manual de operare ,intretinere si service in limba romana

- dimensiuni incapere : 2820x1800 x 2760
- usa incinta : 196x75 cm


NOTA :•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.
•Operatorii economici interesati se vor deplasa la sediul spitalului pentru a vedea incinta.

Camera termostat va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- la livrare produsul vor fi insotit de manual de utilizare in limba romana 1 buc .
- se va asigura service gratuit in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune inclusa in pret
- să se asigure instruirea gratuita a personalului medical si tehnic care va lucra cu termostatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Compartiment de specialitate
Sef Laborator Chimist Aprodu Mihaela
Ing. Hogas Octav

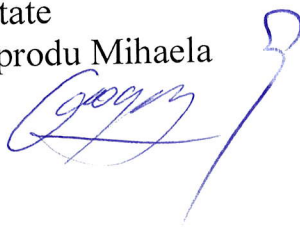

Redactat
Nicolau Gabriela

